

检验检测报告

(电子版)



No: 200027901

防伪查询网址: www.gttc.net.cn


防伪码: UIGG-5177-34

共3页 第1页



委托单位	仙桃市华夏服饰有限公司 地址: 仙桃市工业园区纺织路特1号		
客户认定信息	口罩 30个 颜色: 白色		
检验性质	委托检测	样品受理/测试开始日期	2020-03-03
		报告签发日期	2020-03-09
判定依据	GB 2626-2006 《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》		
综合检验结论	---		
检验检测结果	检验检测项目	判定依据	判定
	NaCl颗粒物过滤效率	GB 2626-2006	符合
	吸气阻力	GB 2626-2006	符合
	呼气阻力	GB 2626-2006	符合
备注	客户要求按KN95判定。 本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。 复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。 本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。		

签发: 刘莲 工程师





样品图片

(电子版)

No:200027901

共3页 第2页

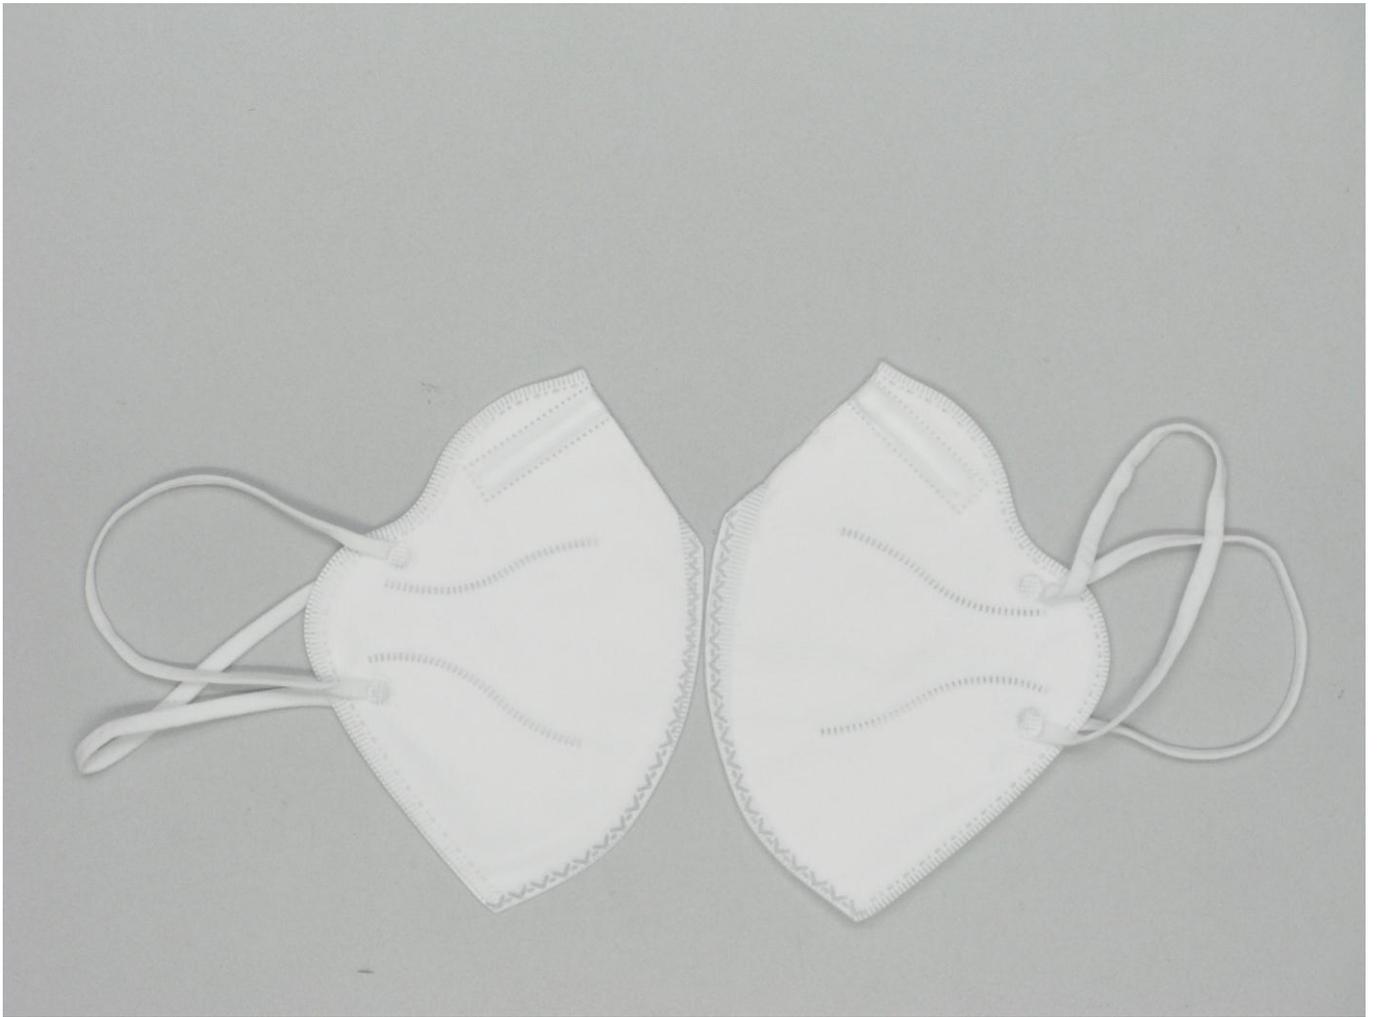

检验检测报告附页 (电子版)

No: 200027901

共3页 第3页

检验检测项目 (计量单位) [样品识别]	测试方法	标准值及允差	检验检测结果	判定	备注
●NaCl颗粒物过滤效率	GB 2626-2006 6.3 空气流量:85L/min 气溶胶颗粒:NaCl 气溶胶浓度:15mg/m ³ 温度:23.1℃ 相对湿度:36.0%	过滤效率(%) : ≥95.0 (KN95)	过滤效率(%) : 未处理样品 1# 99.528 2# 99.708 3# 99.472 4# 99.511 5# 99.548 6# 99.609 7# 99.672 8# 99.634 9# 99.574 10# 99.718 温湿度预处理后样品 1# 99.655 2# 99.564 3# 99.316 4# 99.429 5# 99.518	符合	
●吸气阻力(Pa)	GB 2626-2006 6.5	≤350	未处理样品 1# 67.8 2# 69.3 温湿度预处理后样品 1# 64.2 2# 62.2	符合	
●呼气阻力(Pa)	GB 2626-2006 6.6	≤250	未处理样品 1# 40.3 2# 40.5 温湿度预处理后样品 1# 39.8 2# 37.6	符合	
备 注	(本栏空白)				



——本报告结束——